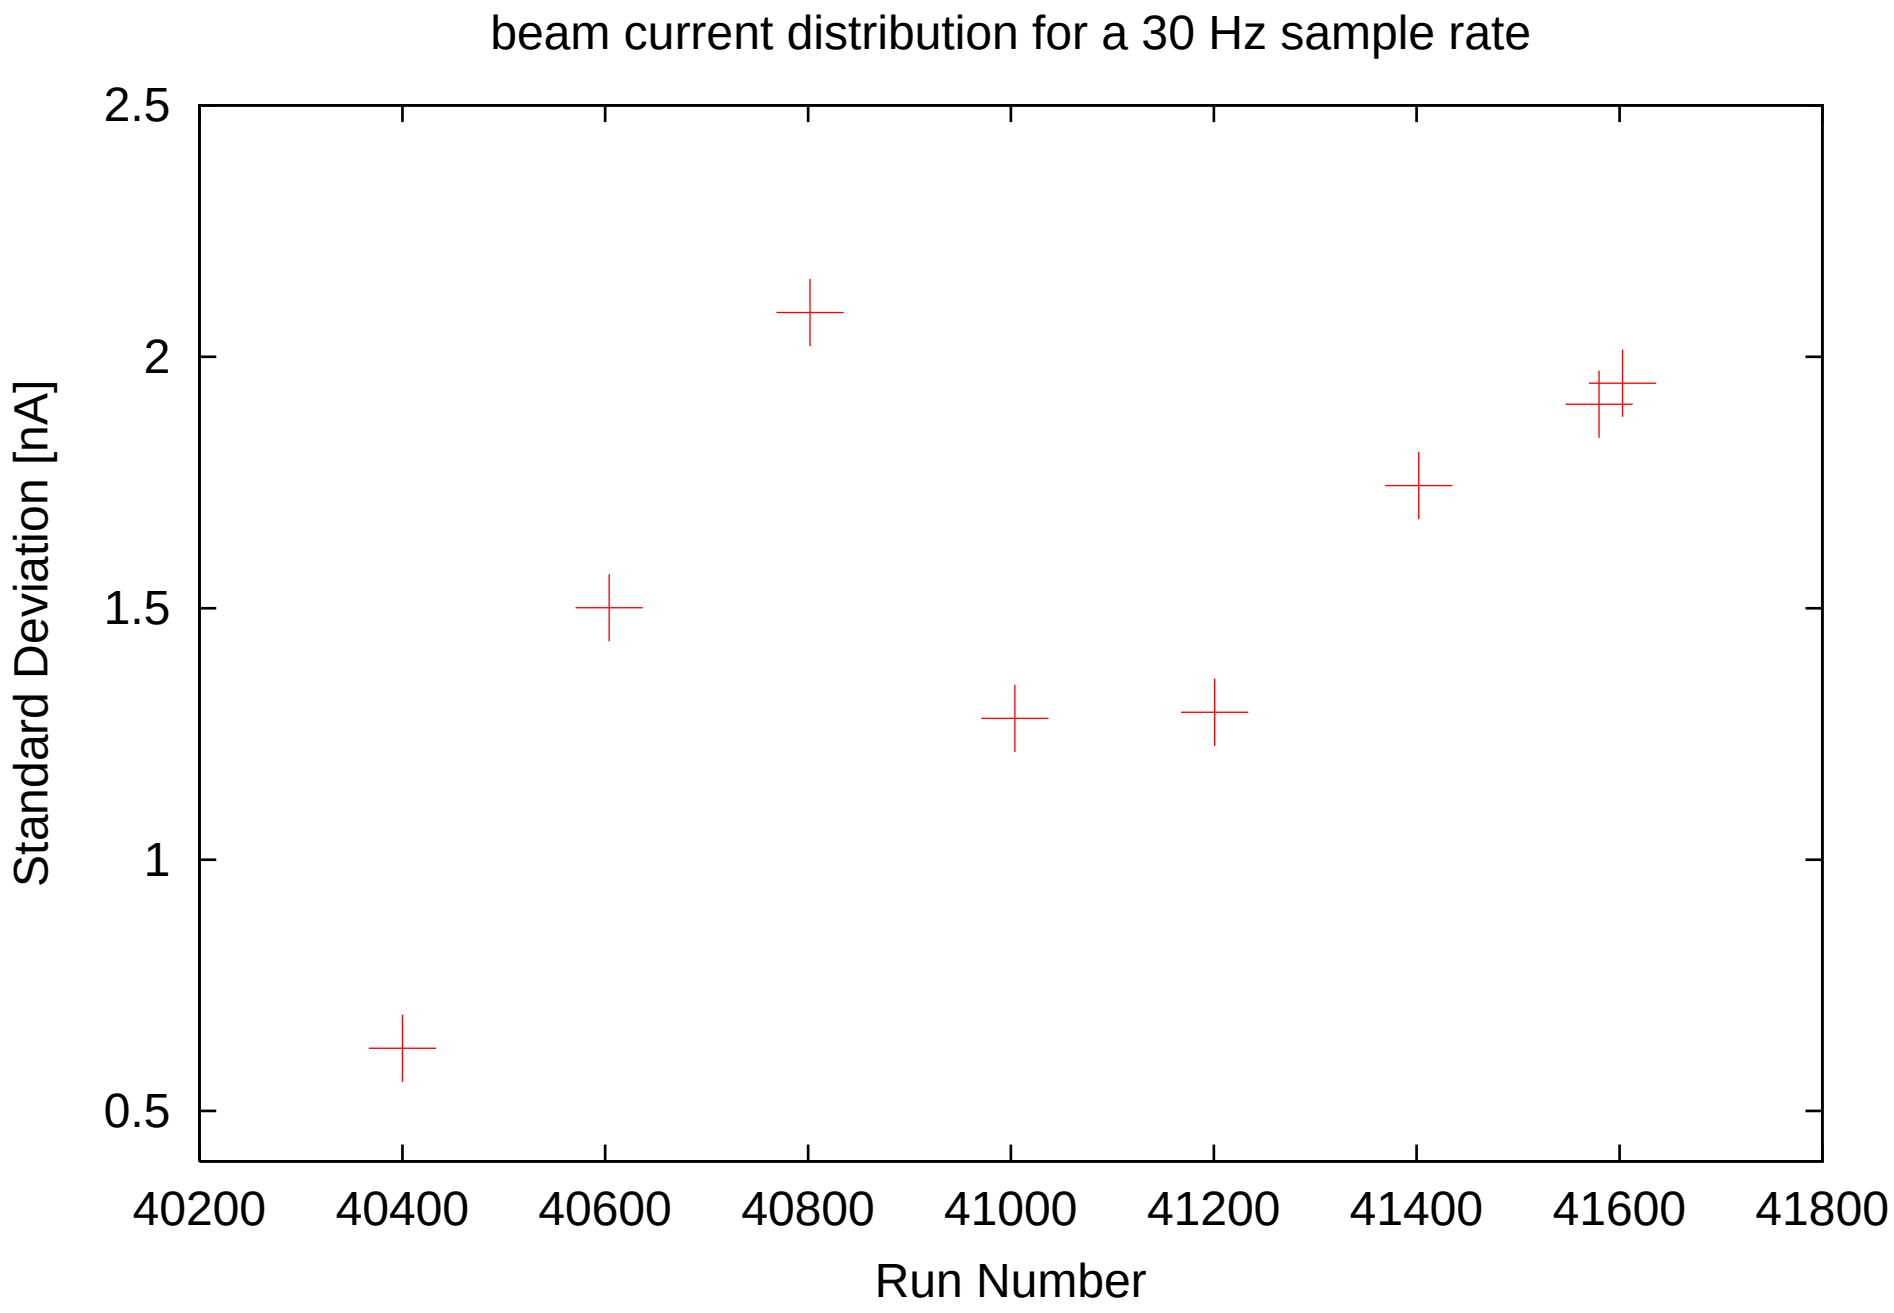
beam current distribution for a 30 Hz sample rate
Standard Deviation [nA]
2.5
2
1.5
1
0.5
40200
40400
40600
40800
41000
41200
41400
41600
41800
Run Number